



**Teklif No** : 677/2018-1305  
**İşin Adı** : 2 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı  
**Alım Şekli** : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin)

2 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı **4734 sayılı Kamu İhale Kanunu** 'nun 22/d bendine göre (**Doğrudan Temin**) göre satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

**Mehmet YILDIZ**  
Hastane Müdürü

### İDARİ ŞARTNAME

#### 1.İdarenin

**a.Adı-Adresi** : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN

**b.Telefon ve Faks Numarası** : 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10

#### 2.İhale Konusu Malın

**a.Malzemeyi İsteyen Ünite**

: Ameliyathane

**b.Niteliği,Türü ve Miktarı**

: Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.

**c.Teslim Yeri**

: Ameliyathane

**d.Teslim Tarihi**

: İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.

#### 3.Teklifin Verilebileceği

**a.Yer** : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun

**b.Son Başvuru Tarihi ve Saati** : 06/04/2018 10:00

#### 4.İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

**a.** Birim fiyat mektubu ve cetveli

**b.** *Teklif edilen malzemeler son başvuru tarihi itibarıyla T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (Bundan sonra "TİTUBB" olarak yazılacaktır.) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. TİTUBB'den onaylı olduğuna dair yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ibaresi olmayan malzemeler ihale dışı bırakılacaktır.*

**c.** *İhale konusu malzemeyi satmaya yetkili olduğuna dair TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarası verilmelidir. TİTUBB'den alınan firma ve/veya bayii tanımlayıcı numarasının yazılı olduğu yazıcı çıktısı teklif zarfı içerisinde konulmalıdır.*

**d.** CE işareti ve onaylı kuruluş kodu Muayene ve Kabul aşamasında kontrol edilecektir.

**e.** Numune: Teklif edilen malzeme için teknik değerlendirmede kullanılmak üzere Ek 2'de belirtilen numune teslim tutanağı ile 5 (Beş) adet numune teslim edilecektir. Numune teslim edilmeyen ürünler için değerlendirme yapılmayacaktır.

**f.** Teklif veren firmalar sattıkları ürünlerin SGK tarafından ödeneceğine, ödenmediği takdirde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacakları gibi Tahakkuk ettirilecek cezayı karşılayacaklarına ilişkin Taahhütnameyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

#### 5.Teklifin Türü

**a.** İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

#### 6.Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

**a.**İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

#### 7.Alternatif Teklifler

**a.** Alternatif teklif verilemez.

#### 8.Kısmi Teklif Verilmesi

**a.** Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir.

#### 9.Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

**a.** Teslim edilecek ürünlerin miadları, teslim tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl olmalıdır. Ürünlerin miadlarının dolmasına 3 (üç) ay kala kurum tarafından yükleniciye yazılı bilgi verilecektir. Yüklenici 3 (üç) iş günü içinde kuruma yazılı olarak izlenecek prosedür konusunda bilgi vermelidir. Yazılı bilgi gelmemesi halinde kurum kendi seçeceği yol ile ürünleri yükleniciye iade eder. Yükleniciye iade edilen ürünler kurum sorumluluğundan çıkar. Yüklenici iadesi yapılan ürünleri 15 (onbeş) gün içerisinde daha uzun miadlıları ile değiştirip kuruma teslim etmek zorundadır. Teslim edilen ürünlerin kurum stoklarından bitimine kadar yüklenici sorumluluğu devam eder.

#### 10.Teklif Geçerlilik Süresi

**a.** Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.

#### 11.Tekliflerin Sunulma Şekli

**a.** Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,tebligata esas açık adresi,teklifin hangi işe ait olduğu,teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır.

Zarfların yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

**b.** Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

**c.** Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dökümanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

## 12. Tekliflerin Alınması

**a.** Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.

## 13. Tekliflerin Değerlendirilmesi

**a.** Zarfları uygun olan ve yeterli kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

## 14. Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

**a.** Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

## 15. Teklifin Karara Bağlanması

**a.** Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

## 16. Sözleşme Yapılması

**a.** Sözleşme yapılmayacaktır.

## 17. Ödeme Yeri ve Şartları

**a.** Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

**b.** **Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 365 (üçyüzaltmışbeş) gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.**

**c.** Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibarıyla faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

## 18. Gecikme Cezası

**a.** İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

**b.** Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

**c.** İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

**d.** Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

**e.** Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen ) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

**f.** Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

## 19. Diğer

**a)** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 20.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

**b)** İstekliler her bir kalem için geçerli olan SUT eki listelerde ilan edilen KDV hariç satış fiyatlarından en az % 15 oranında indirim yaparak tekliflerini hazırlayacaklardır.

**c)** Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfa numerik sayıların 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

**EKİ :** 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli

2. Teknik Şartname

3. Numune Teslim Tutanağı

## ENDOSKOPİK KAPATICI KESİCİ STAPLER KARTUŞU KALIN DOKU 60 MM


1. Dispozitife olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem alın sıra ilaayın zımba aynı işi yapabilmelidir.
4. Endoskopik lineer kesici kartuşunun oluşturduğu zımba hattı uzunluğu en az 60 mm, kesici uzunluğu en az 57 mm olmalıdır.
5. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki kapatıcı zımba yüksekliği 2,0 mm olmalıdır.
6. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba eti en az 3mm, bacak uzunluğu en az 4,0 mm olmalıdır.
7. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba teli çapı en az 0,2mm olmalıdır.
8. Endoskopik lineer kesici kartuşu yerleştirildiği anvil ile multifonksiyonel şekilde kullanıma da uygun omalı dokuları rahatlıkla grasp ve manivela edebilmelidir.
9. Kullanılacak stapler anvil ile tam uyumlu olmalı, stapler kapatıldığında çene ile kartuş birleşime paralel ve dokuya kompresyon yapacak şekilde kapanmalı, ateleme esnasında dokunun ilenya doğru sürülmesi ve ilmesini engelleyecek özellikte olmalıdır.
10. Kartuş rezeksiyon yapılacak dokuda ateleme esnasında ideal zımbalama vs kesme hattı oluşturmalı, tüm zımbalar atelelendiği dokuda düzgün "B" formasyonunu olmalıdır.

11- Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miyadlı olmalıdır.


12-Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarıyla değişeceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değişeceğine tahüt vermelidir VE firma once uzun miyadlı ürünü teslim edecektir , sonra kurumdan yakın miyadlıları teslim alacaktır.

13-Teklif veren firma 5 adet numune teslim etmelidir.

14-Çene kapama gücü zayıf olmamalı , doku staplerin ucundan kaçmamalıdır.



  
Prof. Dr. Mehmet ZASOĞLU  
Göğüs Cerrahisi A.B.D. Başkenti  
E-00234

  
Doç. Dr. AYDEM İZSİZ  
Göğüs Cerrahisi Uzm.  
SS CC 64

  
Doç. Dr.  
Yasemin BİLGİN BÜYÜKARABACAK  
Göğüs Cerrahisi AD  
9804 A-132

ENDOSKOPİK KAPATICI KESİCİ STAPLER KARTUŞU KALIN DOKU 60 MM - 03 135

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem ayrı sıra ilanyum zimba ayrı iş yapabilmelidir.
4. Endoskopik linear kesici kartuşunun oluşturuğu zimba hali uzunluğu en az 50 mm, kesme uzunluğu en az 57 mm olmalıdır.
5. Endoskopik linear kesici kartuşundaki kapat zimba yüksekliği 2.0 mm olmalıdır.
6. Endoskopik linear kesici kartuşundaki zimba eni en az 3mm, bacak uzunluğu en az 4.0 mm olmalıdır.
7. Endoskopik linear kesici kartuşundaki zimba teki çapı en az 0.2mm olmalıdır.
8. Endoskopik linear kesici kartuşu yeniletiği anvil ile multifonksiyonel şekilde kullanıma da uygun olmalı dokuları rahatsızlıkla grasp ve monopolar edebilmelidir.
9. Kullanılacak stapler anvil ile tam uyumlu olmalı, stapler kapatıldığında çene ile kartuş birbirine paralel ve dokuya kompresyon yapacak şekilde kapanmalı, ateşleme esnasında dokunun ilenye doğru sürüklenmesi ve ilmesini engelleyecek özellikte olmalıdır.
10. Kartuş rezeksiyon yapılacak dokuda ateşleme esnasında ideal zimbalama ve kesme hattı oluşturmalı, tüm zimbalar ateşlendiği dokuda düzgün "S" formasyonunu almalıdır.

11- Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miyadlı olmalıdır.

12-Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarıyla değişeceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değişeceğine tahüt vermelidir VE firma önce uzun miyadlı ürünü teslim edecektir , sonra kurumdan yakın miyadlıları teslim alacaktır.

13-Teklif veren firma 5 adet numune teslim etmelidir.

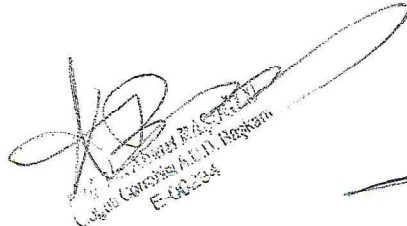
14-Çene kapama gücü zayıf olmamalı , doku staplerin ucundan kaçmamalıdır.

## DISPOSABLE ENDOSKOPİK OYNAR BAŞLI


## TETİKLİ DÜZ KAPATICI VE KESİCİ STAPLER 45MM.

## VASKÜLER/ORTA DOKU KIVRIK UÇLU YÜKLEME ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tamamı disposable olmalıdır.
2. Açık ve Endoskopik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
3. Kartuş zimbaların yer aldığı alt aksam ve zimbaların ateşleme ile beraber "B" formasyonunun oluşmasını sağlayan anvil kısmından oluşmalıdır.
4. Anvil kısmı, staplerin kapatma basıncını dokuya daha iyi aktarabilmesi için sabit ve dayanıklı olmalıdır.
5. Yükleme ünitesi kesme hattının sağına ve soluna üçer sıra zimba yerleştirerek kesmeyi sağlamalıdır.
6. Yükleme ünitesindeki zimbalar, ateşlendikten sonra en uygun lateral sıkıştırma basıncını sağlaması için ve aşağıdaki ölçülere sahip olmalıdır:
  - En içteki zimbaların kapanmadan önceki ölçüsü 2,0 mm, kapandıktan sonraki ölçüsü 0,75 mm;
  - Orta sıradaki zimbaların kapanmadan önceki ölçüsü 2,5 mm., kapandıktan sonraki ölçüsü 1,0 mm;
  - En dış sıradaki zimbaların kapanmadan önceki ölçüsü 3,0 mm kapandıktan sonraki ölçüsü 1,25 mm; Olmalıdır.
7. En dış sıra zimba en yüksek yapıda olmalı, dokuyu daha az sıkıştırmalı, zimba hattı güvenliğini maksimuma çıkarmalıdır.
8. Yükleme ünitesinde zimbaların bulunduğu çenenin yüzeyi, farklı yükseklikteki zimbaların dokuya yerleştirilebilmesi için basamaklı yapıya sahip olmalıdır.
9. Daha rahat ve güvenli ateşleme için yükleme ünitesi ateşlenirken sıkıştırma basıncı lateral olarak yayılmalıdır. Beraberinde yükleme ünitesi kapatılıp ateşlenirken dokunun doğrusal olarak çene dışına hareketini engellenmesi için önce en iç sıra zimba sonra bir arkaki ortasına zimba ve en son bir arkadaki en dış sıra zimba dokuya yerleştirilerek ateşleme gerçekleştirilmelidir. Bu sıra ateşleme süresince böyle devam etmelidir.
10. İç sırada 11 adet, orta sırada 11 adet ve dış sırada 11 adet olmak üzere tek tarafta 33 adet; İki tarafta toplam 66 adet zimba bulunmalıdır.
11. Tel çapları sırayla iç sırada 0.22mm, orta sırada 0.22 mm ve dış sırada 0.22 mm olmalıdır.
12. Daha iyi hemostas ve pneumonostas için zimba sıra sonu konfigürasyonu 4 adet zimbadan oluşmalıdır.
13. Yükleme ünitesi stapler vasıtası ile 5 defa sağa ve 5 defa sola açılabilir olmalıdır. Toplam açılma 45 derece sağa ve 45 derece sola olacak şekilde olmalıdır.
14. Transeksiyon hattının güvenliği için ve çapraz kontaminasyon riskinin azaltılması için her yüklenen kartuşta yeni bir bıçak ve yeni bir anvil olmalıdır.
15. Yükleme ünitesi kalın doku uygulamalarında en iyi "B" formasyonunun oluşması için ateşleme ile beraber üst çeneyi doku üzerine pozisyonlayan bıçağa monte mekanizmaya sahip olmalıdır.
16. Toplam zimba hattı uzunluğu 45 mm olmalıdır.
17. Yükleme ünitesi üzerinde bıçağın harekete geçtiği ve bıçağın durduğu noktaları gösteren çizgiler yer almalıdır.
18. Kartuş kullanılmış kartuşun tekrar kullanılmaması için ateşlemeden sonra tekrar aktive olmamalıdır.

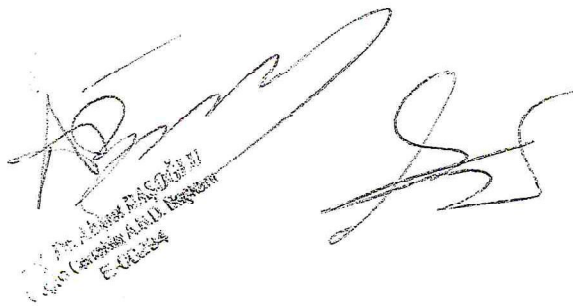
  
 Dr. Mustafa Kemal BAYRAM  
 Genel Cerrahisi / Adli Tıp Bilim Dalı  
 E-002234

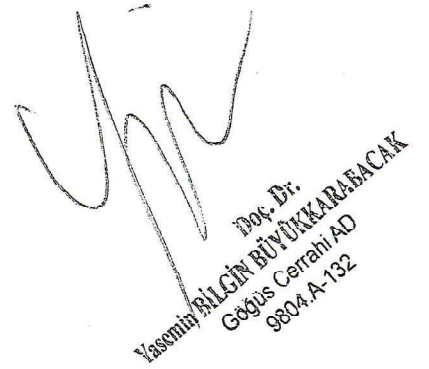


  
 Doç. Dr.  
 YASemin NİÇİN BÜYÜKARABACA  
 Göğüs Cerrahi AD  
 9804 A/132

2. Kalem  
değeri

19. Yükleme ünitesi üzerinde metrik çizgiler yer almalıdır.
20. Yükleme ünitesi 12mm porttan kullanılabilir.
21. Yükleme ünitesinin distal ucu, görüşü kolaylaştıran, diseksiyon yaparak ilgili dokunun arkasına geçebilmeyi ve kartuşu yerleştirmeyi kolaylaştıracak şekilde kıvrık ve altın renkli olmalıdır. Bu kıvrık kısım aynı zamanda atravmatik olmalıdır.
22. Kıvrık uca monte edilerek giriş işlemini kolaylaştıran introducer, esnek radyoopak olmalıdır ve steril paketin içinden çıkmalıdır.
23. Yükleme ünitesinin distal ucundaki kıvrık altın renkli kısım ile esnek radyoopak introducer bir araya geldiğinde kilitlenecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
24. Yükleme ünitesi, staplerinde bulunan grasping özelliği ile tam uyumlu olmalıdır.
25. Kartuş ateşleme esnasında sabit kalmalı ve dokuyu deforme etmemek için staplere doğru çekilmemelidir.
26. Yükleme ünitesinin şaftının üzerinde zımbanın ateşlemeden önceki , ateşlemeden sonraki bacak uzunluklarını , şekillerini ve yükleme ünitesinin tipini gösteren yazılı ibareler bulunmalıdır.
27. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
28. Tıbbi cihaz satınalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.
29. Ürün uhdesine kalan firma tarafından, her ON adet kartuş için bir adet bedelsiz cihaz teslim edilecektir.
30. Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miyadlı olmalıdır.
31. Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarıyla değişeceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değişeceğine tahüt vermelidir VE firma once uzun miyadlı ürünü teslim edecektir , sonra kurumdan yakın miyadlıları teslim alacaktır.
32. Teklif veren firma BİR adet numune teslim etmelidir.
33. Stapler ateşleme esnasında zorlama gerektirmemeli, kullanımı ergonomik ve dayanıklı olmalıdır. Ateşlendikten sonra düzgün bir anostomoz hattı gerçekleştirmeli , kliplerde herhangi bir açılma veya kaçak olmamalı düzgün b formasyonu sağlamalı.

  
Dr. Ali Kemal BAYRAKTAR  
Göğüs Cerrahi AD  
E-020224

  
Doç. Dr.  
Yasemin BİLGIN BÜYÜKARABACAK  
Göğüs Cerrahi AD  
9804-A-132

## DISPOSABLE ENDOSKOPIK OYNAR BAŞLI

## TETİKLİ DÜZ KAPATICI VE KESİCİ STAPLER 45MM.

## VASKÜLER/ORTA DOKU KIVRIK UÇLU YÜKLEME ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tamamı disposable olmalıdır.
2. Açık ve Endoskopik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
3. Kartuş zimbaların yer aldığı alt aksam ve zimbaların ateşleme ile beraber "B" formasyonunun oluşmasını sağlayan anvil kısmından oluşmalıdır.
4. Anvil kısmı, staplerin kapatma basıncını dokuya daha iyi aktarabilmesi için sabit ve dayanıklı olmalıdır.
5. Yükleme ünitesi kesme hattının sağına ve soluna üçer sıra zimba yerleştirilerek kesmeyi sağlamalıdır.
6. Yükleme ünitesindeki zimbalar, ateşlendikten sonra en uygun lateral sıkıştırma basıncını sağlaması için ve aşağıdaki ölçülere sahip olmalıdır:
  - En içteki zimbaların kapanmadan önceki ölçüsü 2,0 mm, kapandıktan sonraki ölçüsü 0,75 mm;
  - Orta sıradaki zimbaların kapanmadan önceki ölçüsü 2,5 mm., kapandıktan sonraki ölçüsü 1,0 mm;
  - En dış sıradaki zimbaların kapanmadan önceki ölçüsü 3,0 mm kapandıktan sonraki ölçüsü 1,25 mm; Olmalıdır.
7. En dış sıra zimba en yüksek yapıda olmalı, dokuyu daha az sıkıştırmalı, zimba hattı güvenliğini maksimuma çıkarmalıdır.
8. Yükleme ünitesinde zimbaların bulunduğu çenenin yüzeyi, farklı yükseklikteki zimbaların dokuya yerleştirilebilmesi için basamaklı yapıya sahip olmalıdır.
9. Daha rahat ve güvenli ateşleme için yükleme ünitesi ateşlenirken sıkıştırma basıncı lateral olarak yayılmalıdır. Beraberinde yükleme ünitesi kapatılıp ateşlenirken dokunun doğrusal olarak çene dışına hareketini engellenmesi için önce en iç sıra zimba sonra bir arkaki ortasına zimba ve en son bir arkadaki en dış sıra zimba dokuya yerleştirilerek ateşleme gerçekleştirilmelidir. Bu sıra ateşleme süresince böyle devam etmelidir.
10. İç sırada 11 adet, orta sırada 11 adet ve dış sırada 11 adet olmak üzere tek tarafta 33 adet; İki tarafta toplam 66 adet zimba bulunmalıdır.
11. Tel çapları sırayla iç sırada 0.22mm, orta sırada 0.22 mm ve dış sırada 0.22 mm olmalıdır.
12. Daha iyi hemostas ve pneumonostas için zimba sıra sonu konfigürasyonu 4 adet zimbadan oluşmalıdır.
13. Yükleme ünitesi stapler vasıtası ile 5 defa sağa ve 5 defa sola açılabilir olmalıdır. Toplam açılma 45 derece sağa ve 45 derece sola olacak şekilde olmalıdır.
14. Transeksiyon hattının güvenliği için ve çapraz kontaminasyon riskinin azaltılması için her yüklene kartuşta yeni bir bıçak ve yeni bir anvil olmalıdır.
15. Yükleme ünitesi kalın doku uygulamalarında en iyi "B" formasyonunun oluşması için ateşleme ile beraber üst çeneyi doku üzerine pozisyonlayan bıçağa monte mekanizmaya sahip olmalıdır.
16. Toplam zimba hattı uzunluğu 45 mm olmalıdır.
17. Yükleme ünitesi üzerinde bıçağın harekete geçtiği ve bıçağın durduğu noktaları gösteren çizgiler yer almalıdır.
18. Kartuş kullanılmış kartuşun tekrar kullanılmaması için ateşlemeden sonra tekrar aktive olmamalıdır.

19. Yükleme ünitesi üzerinde metrik çizgiler yer almalıdır.
20. Yükleme ünitesi 12mm porttan kullanılabilirlidir.
21. Yükleme ünitesinin distal ucu, görüşü kolaylaştıran, diseksiyon yaparak ilgili dokunun arkasına geçebilmeyi ve kartuşu yerleştirmeyi kolaylaştıracak şekilde kıvrık ve altın renkli olmalıdır. Bu kıvrık kısım aynı zamanda atravmatik olmalıdır.
22. Kıvrık uca monte edilerek giriş işlemini kolaylaştıran introducer, esnek radyoopak olmalıdır ve steril paketin içinden çıkmalıdır.
23. Yükleme ünitesinin distal ucundaki kıvrık altın renkli kısım ile esnek radyoopak introducer bir araya geldiğinde kilitlenecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
24. Yükleme ünitesi, staplerinde bulunan grasping özelliği ile tam uyumlu olmalıdır.
25. Kartuş ateşleme esnasında sabit kalmalı ve dokuyu deforme etmemek için staplere doğru çekilmemelidir.
26. Yükleme ünitesinin şaftının üzerinde zımbanın ateşlemeden önceki , ateşlemeden sonraki bacak uzunluklarını , şekillerini ve yükleme ünitesinin tipini gösteren yazılı ibareler bulunmalıdır.
27. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
28. Tıbbi cihaz satınalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.
29. Ürün uhdesine kalan firma tarafından, her ON adet kartuş için bir adet bedelsiz cihaz teslim edilecektir.
30. Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miyadlı olmalıdır.
31. Firma gerktiğinde ürünü farklı boylarıyla değıseceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değıseceğine tahüt vermelidir VE firma once uzun miyadlı ürünü teslim edecektir , sonra kurumdan yakın miyadlıları teslim alacaktır.
32. Teklif veren firma BİR adet numune teslim etmelidir.
33. Stapler ateşleme esnasında zorlama gerektirmemeli, kullanımı ergonomik ve dayanıklı olmalıdır. Ateşlendikten sonra düzgün bir anostomoz hattı gerçekleştirilmeli , kliplerde herhangi bir açılma veya kaçak olmamalı düzgün b formasyonu sağlamalı.





### BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TEKLİF NUMARASI : 677/2018-13052 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı  
SON BAŞVURU TARİHİ : 06/04/2018 10:00

0

Teklif Sahibinin / Firma Unvanı,Uyruğu :  
Adı Soyadı / Firma Unvanı,Uyruğu :  
Açık Tebligat Adresi :  
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :  
Telefon Numarası :  
Fax Numarası :  
E-mail Adresi :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

S. No	UBB KODU	Malzeme Adı	Markası	KDV Or.	SUT kodu	Miktar	Birim	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1		kartuş endoskopik lineer kapatıcı kesici 60mm-kalın doku E				150	Adet		
2		Kartuş Stapler Endoskopik Lineer Kapatıcı-Kesici 45mm Eğri ( Kahve )				50	Adet		

**TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)**

#### NOT: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

3- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idareizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmını için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

5- Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 365 (üçyüztümüşbeş) gün içerisinde ödenecektir.

Ad ve SOYAD-Firma Kaşe  
İmza

## NUMUNE TESLİM TUTANAĞI

Tarih: / /

TEKLİF NUMARASI : 677/2018-13052 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı  
SON BAŞVURU TARİHİ : 06/04/2018 10:00  
İSTEK YAPAN BÖLÜM : Ameliyathane

S. No	Teklif Sıra No	Malzeme Adı	Markası	Üretici Firma Adı	Menşei	Miktar	Birim
1		kartuş endoskopik lineer kapatıcı kesici 60mm-kalın doku E					
2		Kartuş Stapler Endoskopik Lineer Kapatıcı-Kesici 45mm Eğri ( Kahve )					

Yukarıda yazılan numune / numuneler tarafımızdan teslim alınmıştır.

Teslim Edilen Bölüm:

HASTANE GENEL DEPOSU

Teslim Tarihi :

Teslim Alanın

Teslim Eden Firma

Adı Soyadı :

Ünvanı :

Not: Teklifler numune teslim tutanağı kurum yetkilisince imzalı olmak kaydıyla teklif ve tutanak birlikte verilecektir. Numune teslim tutanağı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.