



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi Dekanlığı



2025 AİLE YILI

Sayı : E-19054817-604.99-2500094318
Konu : Malzeme Alımı.

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz BAP tarafından destekli BAP01-2024-5095 no.lu proje için ekteki teklif mektubunda belirtilen 2 kalem malzeme alımı;

Yükseköğretim Kurumları tarafından , 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihale doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari ve Teknik Şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak söz konusu 2 kalem malzeme alım işinin firmanız tarafından temini mümkün ise teklifinizin ekteki teklif mektubu ile 07.05.2025 günü saat 16.00'ya kadar aşağıda belirtilen adreslere ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Not: Alıma ilişkin belgelere 19 Mayıs Üniversitesi Web sayfası üzerinden (www.omu.edu.tr) “hızlı erişim/ihale duyuruları/doğrudan teminler”linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Adres:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Atakum/SAMSUN

E-posta: omutip@omu.edu.tr

Tel: 0 362 312 19 19

EK. 2 Kalem malz.

Prof. Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER
Dekan V. V.



T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

İlan No : 644 Son Teklif Tarihi 7.05.2025 16:00:00
Proje Yürütücüsü : Prof.Dr. Şengül Tural / BAP01-2024-5095
Proje No :
Açıklama : Tekliflerin omutip@omu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI SOYADI / FİRMA ADI :
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :
VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI :
BANKA VE IBAN NUMARASI :
TELEFON VE FAX NUMARASI :
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan..... teklif nolu alıma ilişkin bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü rica ederiz.

Sıra No	Malzeme	Marka / Model	KDV	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Tutar
1	MICRORNA ASSAY QRT PRIMER PROBU HSA-miR-186-5p			1	Adet		
2	TAQMAN REVERSE TRANSCRIPTION REAGENTS, (200 REAKSIYON)			1	Adet		
TOPLAM							

(YalnızTürk Lirasıdır.)

Fiyatlarda KDV Hariçtir.

- 1- Teklifimiz gün geçerlidir.
- 2- Söz konusu ihale işine ait malzemeleri sipariş tarihine müteakip en geç gün içinde teslim edeceğiz.
- 3- Alternatif teklif verilmemiştir.
- 4- Teklifimiz ilana çıkılan alımların kalem sıralamasına ve birim miktarlarına uyularak hazırlanmıştır.
- 5- Tekliflerimizde teknik şartnameye uygun ürün vermeyi Kabul Ediyoruz.
- 6- Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı kabul ediyoruz.
- 7- Ürünlerle ilgili yaşanacak bütün problemlerin giderilmesi tarafımıza aittir.

FİRMA
İMZA/KAŞE



Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Proje Süreçleri Yönetim Sistemi



(/)

MEVZUAT (/ASMevzuat.aspx)

SATINALMA DUYURULARI (/SatinalmaDuyurulari.aspx)

BAP RAPORLARI (/BapRaporlari2.aspx)

İLETİŞİM (/ASiletisim.aspx)

Kullanıcı İşlemleri

ÇIKIŞ (Exit.aspx)

2 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı

İlan/Teklif No: 644

Proje Kodu: BAP01-2024-5095

Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Şengül Tural

Onay Tarihi/Sayısı: 1155

Yürütücünün Birimi: Tıp Fakültesi

Yayınlanma Tarihi: 30.04.2025 09:00:00

Ekleyen: GÜRKAN ŞENOL

Son Teklif Tarihi: 7.05.2025 16:00:00

Açıklama: Tekliflerin omutip@omu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. (<https://bilimap.org/>)

Teklif Formu Hazırla

Yazdır

Sıra	Tanımı/Adı	Miktar	Kalan	Birim	Alım Kalemi Şartnamesi	Genel Şartname
1	MICRORNA ASSAY QRT PRIMER PROBU HSA-miR-186-5p	1		Adet		
2	TAQMAN REVERSE TRANSCRIPTION REAGENTS, (200 REAKSIYON)	1		Adet		

Görüntülenme Sayısı:

Mevzuat (/ASMevzuat.aspx)

Satınalma Duyuruları (/SatinalmaDuyurulari.aspx)

Proje Arşiv Arama (/ASProjeArama.aspx)

TAQMAN™ REVERSE TRANSCRIPTION REAGENTS TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ürün RNA çalışmaları için Real Time PCR uygulamalarına uygun olmalıdır
- 2-Ürün 200 reax.luk ambalajda olmalıdır
- 2-Optium reax cıcaklığı 42°C olmalıdır
- 3-Konsantrasyon 50 u/ul olmalıdır
- 4-Başlangıç materyali RNA olmalıdır
- 5-Nihai ürün First-Strand cDNA olmalıdır
- 6-Kuru buz içinde teslim edilmelidir
- 7-Ürün firma tarafından teslim edilmelidir. Kargo ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.
- 8-Ürünle birlikte çalışma için gerekli sarf malzemeleri 200 örneklik doku.kan v.s RNA izolasyon kiti,1 adet 1 ml .lik TaqMan™ Universal Master Mix II, no UNG birlikte verilmelidir.
- 9-Şartnameye uymayan ve eksik gelen ürünler kabul edilmeyecektir.

MICRORNA ASSAY QRT PRIMER PROBU HSA-MIR-19B,3P

- 1-Ürün miRNA çalışmalara uygun olmalıdır
- 2-Ürün 500 reax.ambalajda olmalıdır
- 3-Konsantrasyon 10 mg/ml olmalıdır
- 4-Soğuk zincir ile firma tarafından teslim edilmelidir. Kargo ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.
- 5-Ürün çalışmadığında firma yenisini sağlamakla yükümlü olup 1 ay içinde teslim etmelidir

MICRORNA ASSAY QRT PRIMER PROBU HSA-MIR-186-5B

- 1-Ürün miRNA çalışmalara uygun olmalıdır
- 2-Ürün 500 reax.ambalajda olmalıdır
- 3-Konsantrasyon 10 mg/ml olmalıdır
- 4-Soğuk zincir ile firma tarafından teslim edilmelidir. Kargo ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.
- 5-Ürün çalışmadığında firma yenisini sağlamakla yükümlü olup 1 ay içinde teslim etmelidir

PİPETÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Otomatik pipet genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun özellikte olmalı ve pipetin tümü 100% otoklavlanabilir (121 °C'de 20 dk.) olmalıdır
2. Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal solventlere karşı dirençli polipropilen malzeme olmalıdır.
3. Pipet 0,5-10 ul aralıklarda çalışmaya uygun olmalıdır
4. Pipetlerin içyapısı otoklavlanma özelliğinde ve seramik piston bulunmalıdır.
5. Pipetler UV ışınlarına dirençli olmalıdır.
6. Pipet taksimatı 0,01 ul olmalıdır.
7. Pipetler digital ekrana sahip olmalı ve bu ekran sayesinde pipetleme volümü görülebilir ve ayarlanabilir olmalıdır.

8. Pipetlerin ayarlama kısmının tek aşamalı kilit mekanizması bulunmalıdır.
9. Pipetlerin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli, otoklavlanabildiğini belirten yazı ve CE işareti, kutusunda ise kalibrasyon sertifikası ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
10. Pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilir ve kalibrasyonu yapılabilir olmalıdır
11. Pipetlerin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.
12. Pipet ile birlikte, her biri steril filtreli olmak üzere 10 kutu 10 ul pipet ucu birlikte verilmelidir
13. Pipetlerin TURKAK onaylı kalibrasyon sertifikaları olmalıdır
14. Pipetler en az 2 yıl garantili olmalıdır.
15. Pipet ISO ve CE belgesine sahip olmalıdır.
16. Pipetlerin bakım ve onarım servisi bulunmalıdır.

PCR PLATE 96 KUYUCUKLU DÜŞÜKPROFİLLİ,İNCE DUVARLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-96 kuyucuklu düşük profilli ve ince duvarlı olmalıdır
- 2-Şeffaf polipropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır
- 3-Paket içinde100 adet plate bulunmalıdır
- 4-Biorad qpcr cihazına uygun olmalıdır

MICROSEAL B PLATE SEALİNG FİLM ADHESIVE OPTICAL

- 1-96 kuyucuklu pcr plate ler için uygun olmalıdır
- 2-Şeffaf olmalıdır
- 3-Yapışkanlı olmalıdır
- 4-Paket içinde 200 adet olmalıdır

GENEL TEKNİK ŞARTNAME


- 1-Tüm kalemlerin birlikte uyumlu çalışması için teklif edilen tüm ürünler aynı marka ve firmanın ürünü olmalıdır. Farklı markalardan oluşan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklif veren firmalar ürünlerin tamamına teklif vermelidir.
- 3-Ürünler kuru buz taşıma şartlarında firma tarafından bizzat teslim edilmelidir. Kargo ile yapılan gönderiler teslim alınmayacaktır.

TAQMAN™ REVERSE TRANSCRIPTION REAGENTS TEKNİK ŞRATNMESİ

- 1-Ürün 200 reax ambalajda olmalıdır
- 2-Optium reax cıcaklığı 42°C olmalıdır
- 3-Konsantrasyon 50 u/ul olmalıdır
- 4-Başlangıç materyali RNA olmalıdır
- 5-Nihai ürün First-Strand cDNA olmalıdır
- 6-Kuru buz içinde teslim edilmelidir
- 7-Ürün ile birlikte 1 adet 5 ml Taqman™ universal master mix II, with ung birlikte verilmelidir
- 8- Ürün için çalışma garantisi verilmeli, çalışmayan ürün yenisi ile ücretsiz değişim sağlanmalıdır

TAQMAN® MICRORNA ASSAY QRT PRIMER PROBLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Tüm ürünler en az 200 reax ambalajda olmalıdır
- 2-QPCR ile çalışmaya uygun olmalıdır
- 3-Tüp formatında olmalıdır
- 4-Taqman probları ve primer setlerini içermelidir
- 5-Sipariş edildikten sonra 1 ay içinde teslim edilmelidir
- 6-Ürün için çalışma garantisi verilmeli, çalışmayan ürün yenisi ile ücretsiz değişim sağlanmalıdır

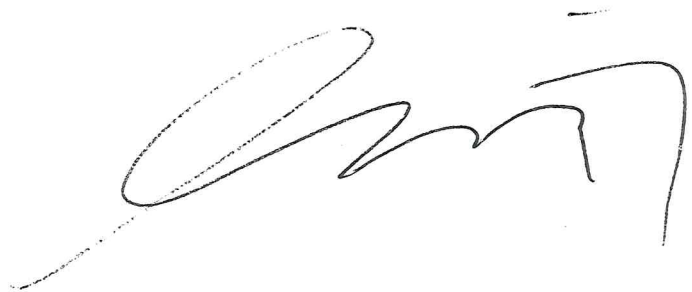

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne

Yürütücüsü bulunduğum BAP01-2024-5095 nolu ve "Çocukluk Çağı Hemofili Hastalarında miR19b3p and miR1865p Ekspresyon Seviyelerinin İncelenmesi" başlıklı proje kapsamında aşağıdaki satınalma/harcama işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda gereğini arz ederim .

Doc.Dr. Şengül Tural
Tıp Fakültesi

Proje Başlangıç - Bitiş Tarihi : 18.04.2024 - 18.10.2025
Proje Türü: : Genel Araştırma Projeleri
Proje Genel Bütçesi (Mal, Malzeme, Hizmet) : 197588,40

Genel Satın Alma Talebi

<u>SIRANO</u>	<u>MALZEME</u>	<u>MIKTAR</u>	<u>BİRİMİ</u>
1	MICRORNA ASSAY QRT PRIMER PROBU HSA-miR-186-5p	1	Adet
2	TAQMAN REVERSE TRANSCRIPTION REAGENTS, (200 REAKSIYON)	1	Adet

ONAY BELGESİ													
İDAİRENİN ADI	O.M.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi												
Belge Tarihi - Onay Sayısı	18/04/2025 - 1155												
REKTÖRLÜK MAKAMINA													
ALIM İLE İLGİLİ BİLGİLER													
İŞİN TANIMI / NİTELİĞİ	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları / Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları												
İŞİN MİKTARI	2 Kalem												
YAKLAŞIK MALİYET													
KULLANILABİLİR ÖDENEK TUTARI	75105,6 TL												
PROJE NUMARASI (varsa)	BAP01-2024-5095												
BÜTÇE TERTİBİ	56.178.749.2392.422.1.02.03.02.90.90												
AVANS VERİLECEKSE ŞARTLAR	Verilmeyecektir												
ALIM USULÜ	4734 Say. K.İ.K.'nın 3(f) bendi uyarınca çıkarılan 2025/9652 sayılı CB Kararının 8/c maddesi												
FİYAT FARKI ÖDENECEKSE DAYANAĞI	Fiyat Farkı Ödenmeyecektir.												
ALIM İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR													
Üniversitemizde yürütülmekte olan "Çocukluk Çağı Hemofili Hastalarında miR19b3p and miR1865p Ekspresyon Seviyelerinin İncelenmesi" isimli projede kullanılmak üzere, <table><thead><tr><th>Sıra No</th><th>Malzeme</th><th>Miktar</th><th>Birimi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>MICRORNA ASSAY QRT PRIMER PROBU HSA-miR-186-5p</td><td>1</td><td>Adet</td></tr><tr><td>2</td><td>TAQMAN REVERSE TRANSCRIPTION REAGENTS, (200 REAKSIYON)</td><td>1</td><td>Adet</td></tr></tbody></table> 2 Kalem kalem mal/malzeme/hizmet alınması istenmektedir.		Sıra No	Malzeme	Miktar	Birimi	1	MICRORNA ASSAY QRT PRIMER PROBU HSA-miR-186-5p	1	Adet	2	TAQMAN REVERSE TRANSCRIPTION REAGENTS, (200 REAKSIYON)	1	Adet
Sıra No	Malzeme	Miktar	Birimi										
1	MICRORNA ASSAY QRT PRIMER PROBU HSA-miR-186-5p	1	Adet										
2	TAQMAN REVERSE TRANSCRIPTION REAGENTS, (200 REAKSIYON)	1	Adet										
Not: Piyasa Araştırma Görevlisi-Prof.Dr. Şengül Tural - GÜRKAN ŞENOL													
ONAY													
Yukarıda belirtilen malın alınması hususunu onaylarınıza arz ederim. 18/04/2025 Gerçekleştirme Görevlisi İdari Personel ERCAN EDİZ	UYGUNDUR 18/04/2025 Harcama Yetkilisi Prof.Dr. ORHAN DENGİZ Koordinatör												